

発行 No. : UKQ19-D1414
発行年月日: 2019-08-05

依頼者名 株式会社中央設備

校正証明書

測定機器

品名	ダイヤルゲージ
型式 (符号)	-----
コード No.	1160T
製造 No.	TGG504
製造者	株式会社ミットヨ
校正結果 / 検査成績書発行 No.	UK19-D1414
校正 / 検査年月日	2019-07-31

本校正に用いた主要標準器

標準器名	インジケータ検査機
型式 (符号)	IC1000
コード No.	170-301-10
製造 No.	0410709
製造者	株式会社ミットヨ
管理 No.	UST007
有効期限	2019年11月末日

結果は別紙 (校正結果 / 検査成績書) の通りであることを証明します。

栃木県宇都宮市下栗町2200-1

株式会社ミットヨ テクノサービス事業本部
宇都宮キャリブレーションセンタ


センタ長 大西 岳



この証明書は、国家標準にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。
株式会社ミットヨの書面による承認なしに、この証明書の一部のみを複製して使用することを禁じます。



ダイヤルゲージのトレーサビリティ体系図

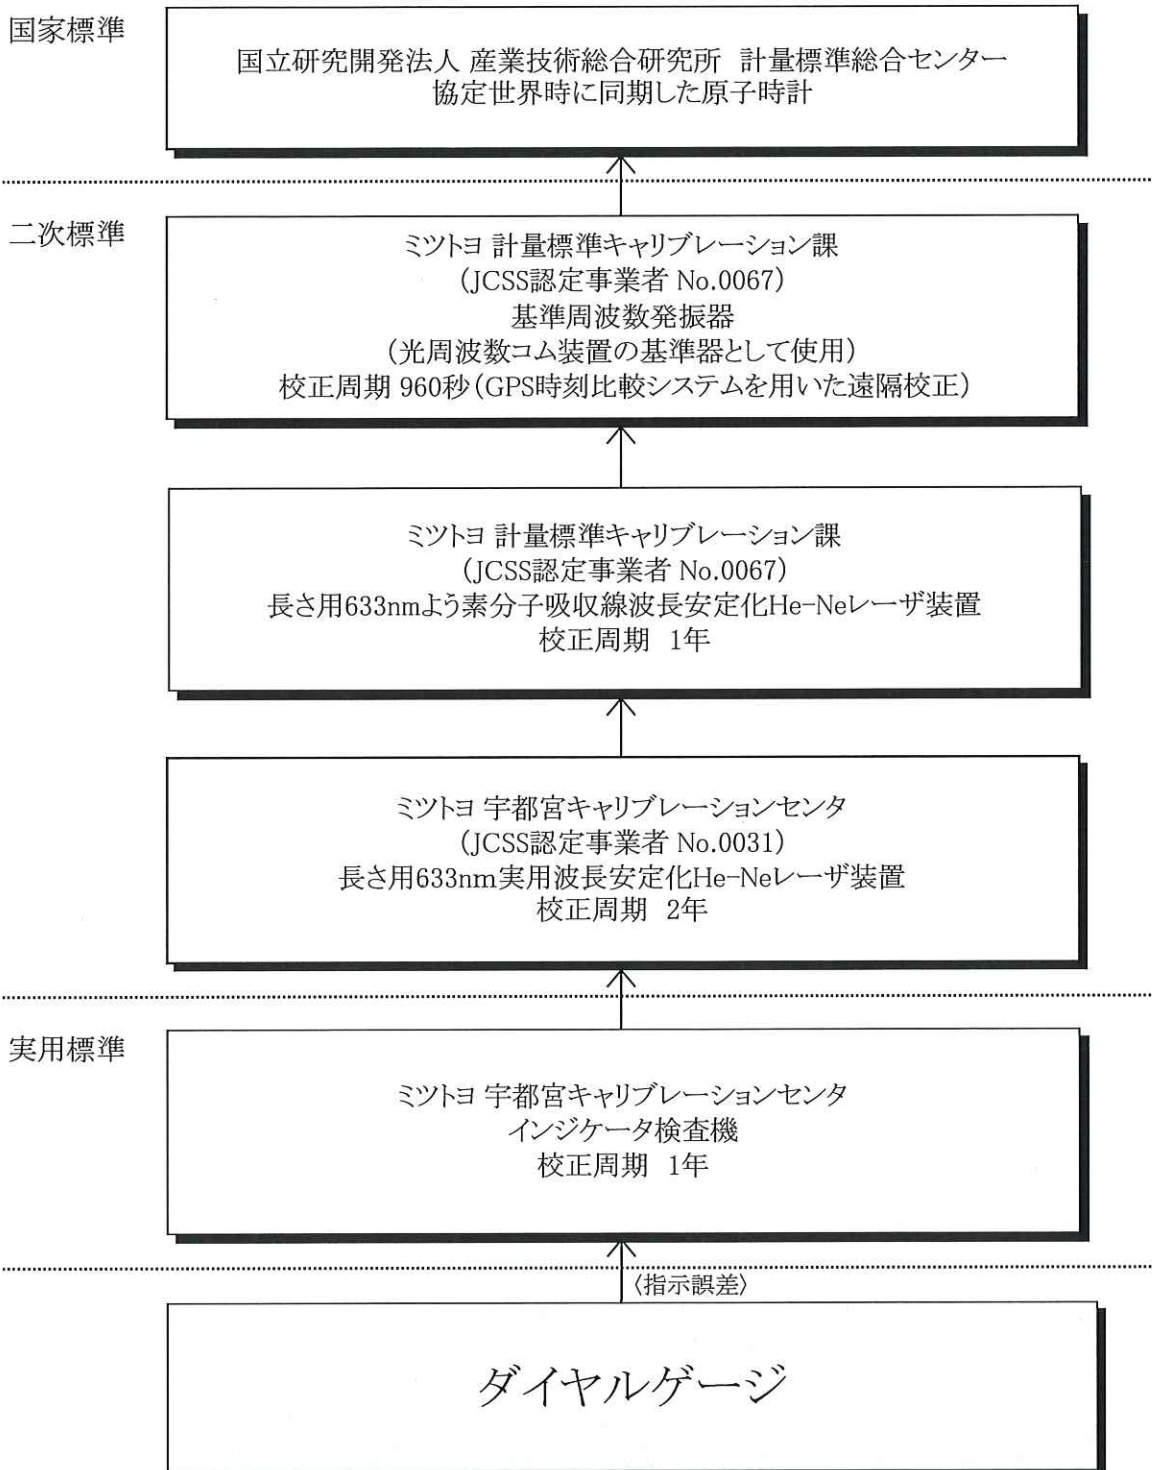

発行 No. UK19-D1414

発行年月日 2019-07-31

検査成績書

品名 ダイヤルゲージ
 符号 —
 コード No. 1160T
 製造 No. TGG504
 測定範囲 5 mm
 目量 0.01 mm

検査年月日 2019-07-31
 温度 20 °C(標準温度)
 検査規格 ミットヨ規格




1. 検査結果

- (1) 外観: 良
- (2) 機能: 良
- (3) 性能:

単位: μm

精度		最大許容誤差	測定値
指 示 誤 差	1/10 回転	8	1.8
	1/2 回転	12	2.7
	1 回転	14	3.1
	全測定範囲	16	6.6
戻り誤差		4	1.1
繰返し精密度		3	1

※検査姿勢は縦姿勢です



2. 総合判定: 合格

株式会社ミットヨ